

# Automatize a normalização de amostras com o Bravo Agilent e o BioTek Synergy

Aumente a produtividade e o tempo de automação enquanto melhora a precisão e a reprodutibilidade no preparo de amostras

## Manuseador de líquidos Bravo



### Preparar amostras


RNA, DNA, proteína

## Leitor BioTek Synergy



### Medir amostras

$A_{260}$ ,  $A_{280}$ , fluorescência

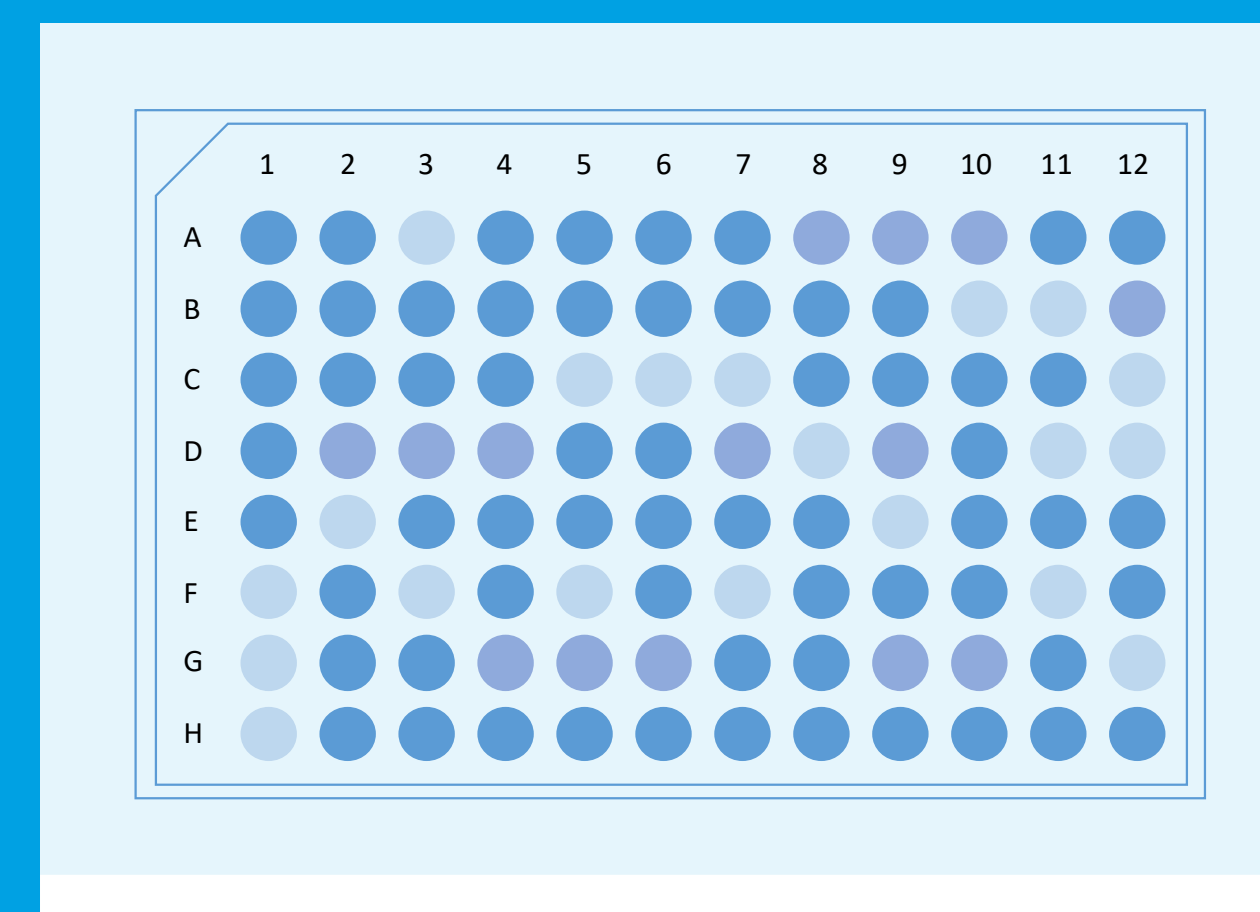

### Vincular valores de amostra

Valores de concentração automaticamente calculados e vinculados

## Manuseador de líquidos Bravo



### Normalizar amostras

Execução do protocolo de normalização gerado automaticamente



Trabalhando juntos. Trabalhando para você.

Saiba mais sobre as tecnologias que impulsionam as descobertas futuras.  
Visite [www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy](http://www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy)



DE.3591782407  
Somente para uso em pesquisas. Não deve ser usado em procedimentos de diagnóstico. Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2020  
Publicado nos EUA, quarta-feira, 20 de maio de 2020  
5994-1975PTBR