


# Автоматизированный отбор проб на системе Agilent Bravo со сканером BioTek Synergy

Увеличение производительности и автономности системы с одновременным повышением точности и воспроизводимости пробоподготовки

## Система дозирования жидкостей Bravo



## Сканер BioTek Synergy

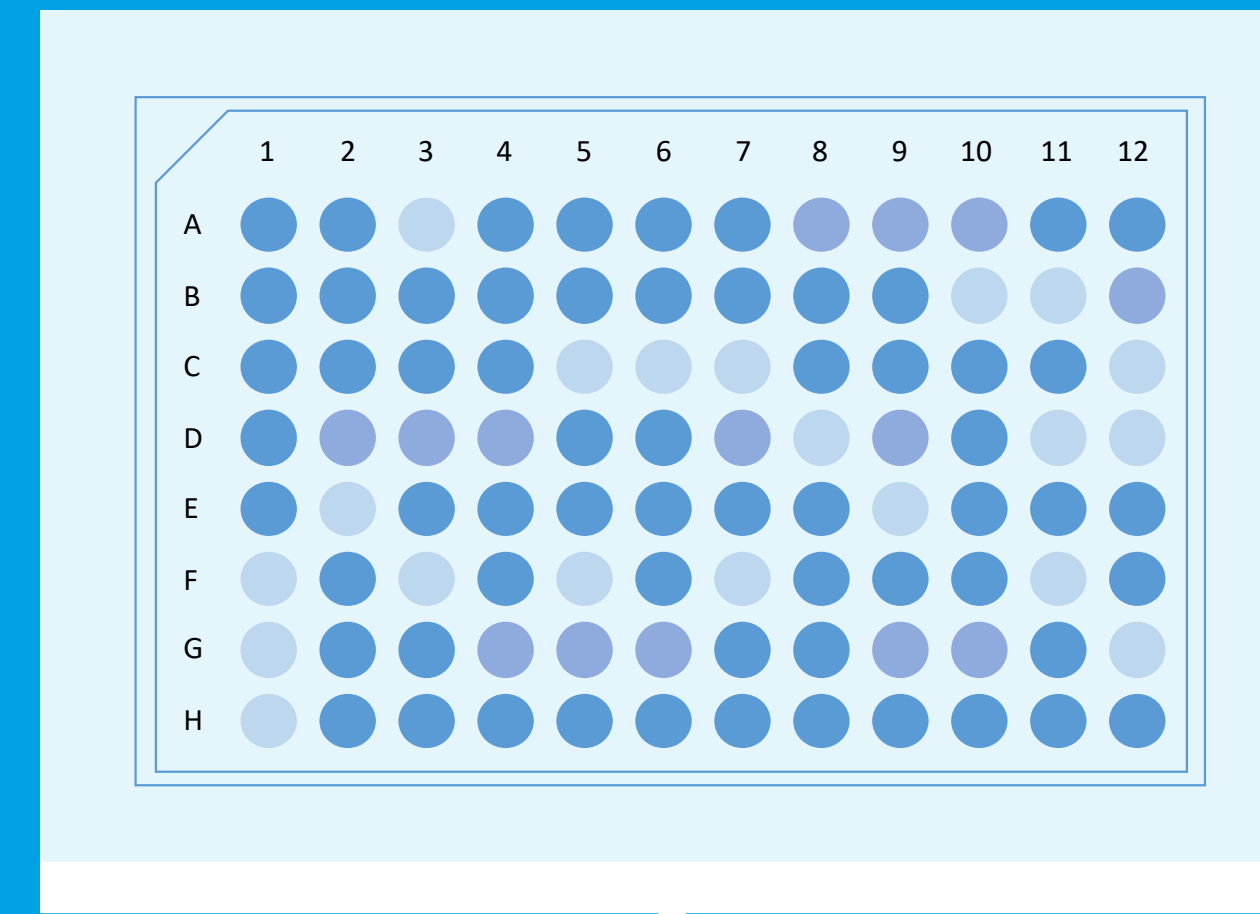

## Система дозирования жидкостей Bravo



Пробоподготовка  
РНК, ДНК, белок

Анализ проб  
 $A_{260}$ ,  $A_{280}$ , флуоресценция

Обмен значениями  
Автоматический расчет и обмен значениями концентраций

Нормализация проб  
Запуск автоматически созданных протоколов нормализации



Работают вместе. Работают для вас.

Узнать больше о технологиях будущих открытий.  
Посетите [www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy](http://www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy)



DE.3591782407

Только для исследовательских целей.  
Не для использования в диагностических процедурах.  
Информация в этом документе может быть изменена без уведомления.

© Agilent Technologies, Inc., 2020  
Напечатано в США, 20 мая 2020 г.  
5994-1975RU