


Der Tag hat 24 Stunden. Wie wollen Sie diese Zeit nutzen?

Mit Agilent Captiva EMR–Lipid können Sie bei der Probenvorbereitung auf einfache Weise die drei zeitaufwendigsten Probleme, die durch Lipidablagerungen entstehen, minimieren und eine bessere Datengenauigkeit und Präzision erreichen.

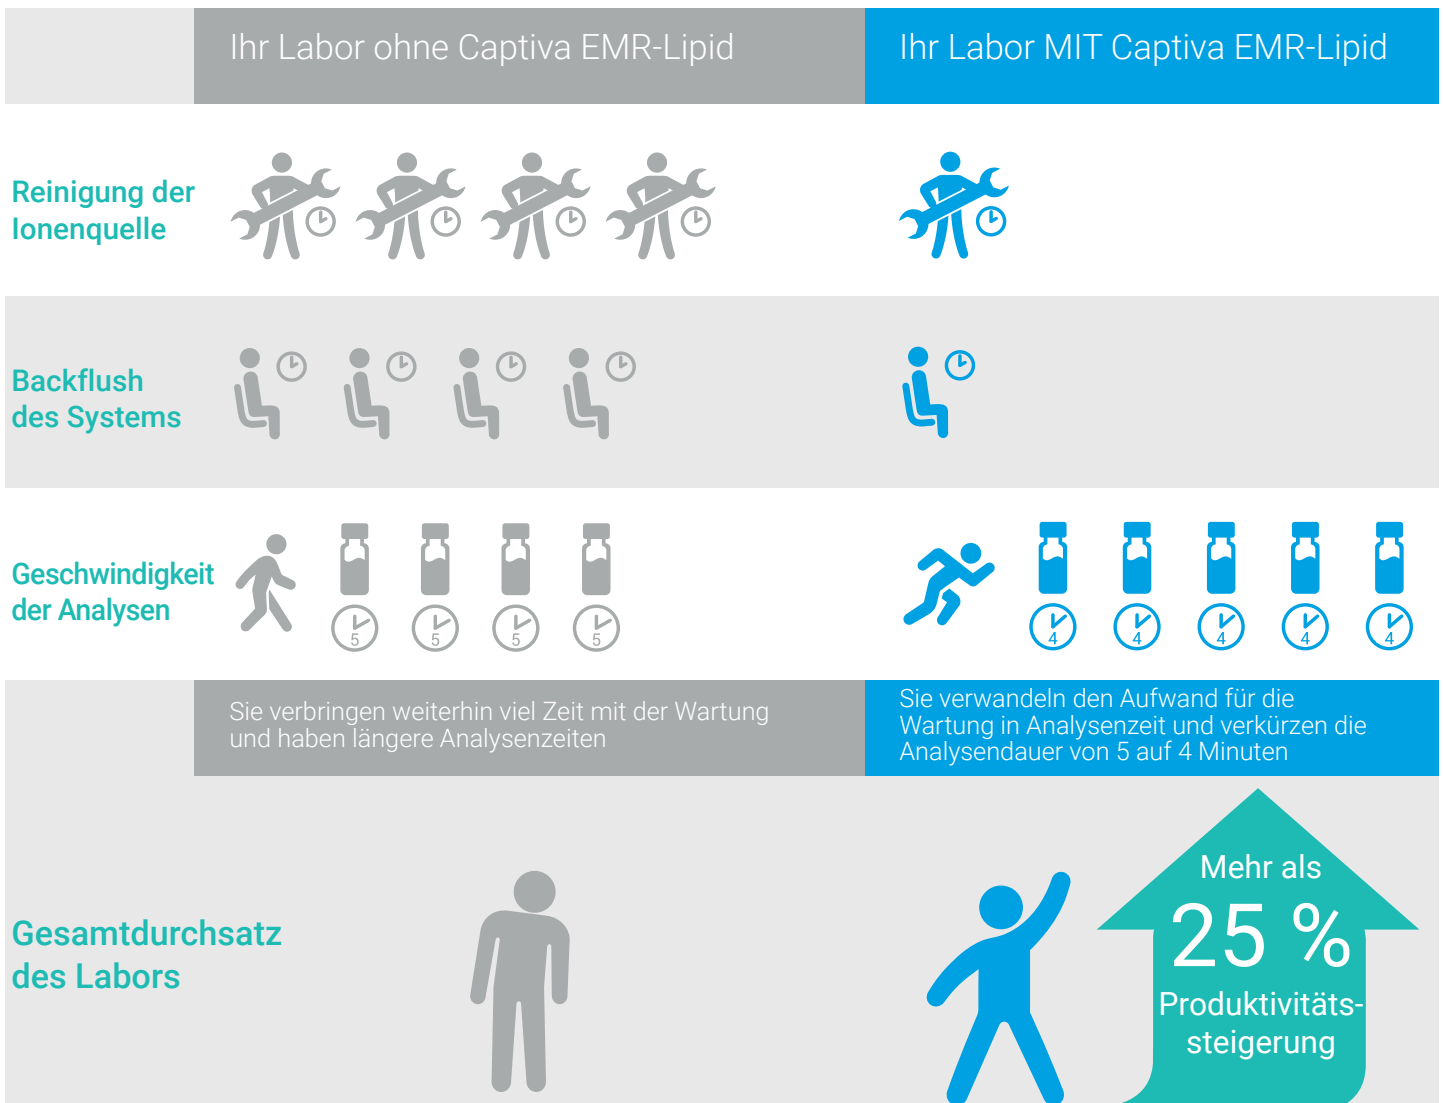

Dieses Szenario gilt für ein Labor mit hohem Probendurchsatz, das mit einem einzelnen Gerät (LC/MS/MS) ungefähr 6500 Proben pro Monat analysiert. Dieses Labor arbeitet rund um die Uhr mit einer LC-Analysendauer von 5 Minuten. Im aktuellen Zustand müssen die Labortechniker in diesem Labor routinemäßig einmal im Monat die Säule spülen und die MS-Quelle reinigen.

Änderungen vorbehalten.

Möchten Sie mehr über das Potential zur Steigerung der Produktivität erfahren? Sehen Sie sich um:

www.agilent.com/chem/did-you-know