


# El día tiene 24 horas. ¿A qué desea dedicarlas?

Solo con usar productos **Lípidos - EMR Captiva** de Agilent para la preparación de muestras, minimizará tres factores que consumen mucho tiempo y están asociados a la acumulación de lípidos, lo que mejorará la precisión y la exactitud de los datos.

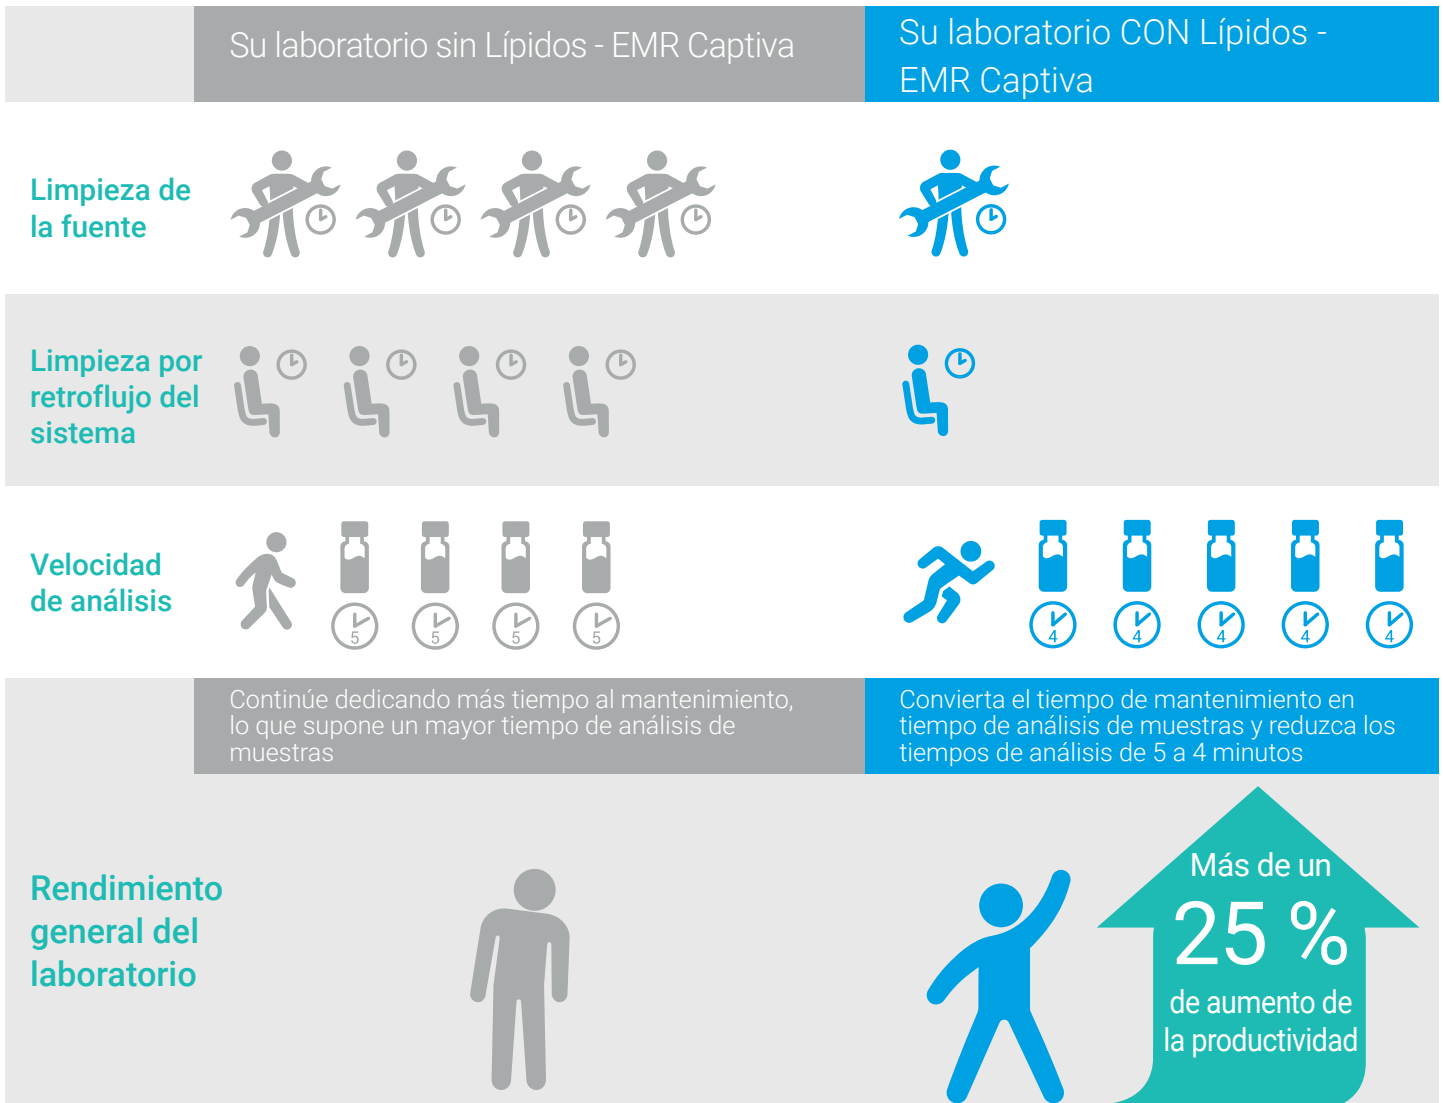

Este supuesto se basa en un laboratorio de alta productividad que analiza unas 6.500 muestras al mes en un solo instrumento (LC/MS/MS). El objetivo del laboratorio es funcionar durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana con un tiempo de análisis por LC de 5 minutos. En este laboratorio, los técnicos tienen que limpiar la columna de forma rutinaria y limpiar la fuente de MS una vez al mes en la situación actual.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

¿Está interesado en conocer más sobre posibles mejoras en la productividad? Comience a explorar:  
[www.agilent.com/chem/did-you-know](http://www.agilent.com/chem/did-you-know)