


# In un giorno ci sono solo 24 ore. Che uso ne vuoi fare?

Ti basta utilizzare Agilent Captiva EMR–Lipid per la preparazione del campione per ridurre al minimo tre aspetti legati all'accumulo di lipidi che comportano un grande dispendio di tempo, ottenendo un maggior livello di accuratezza e precisione dei dati.

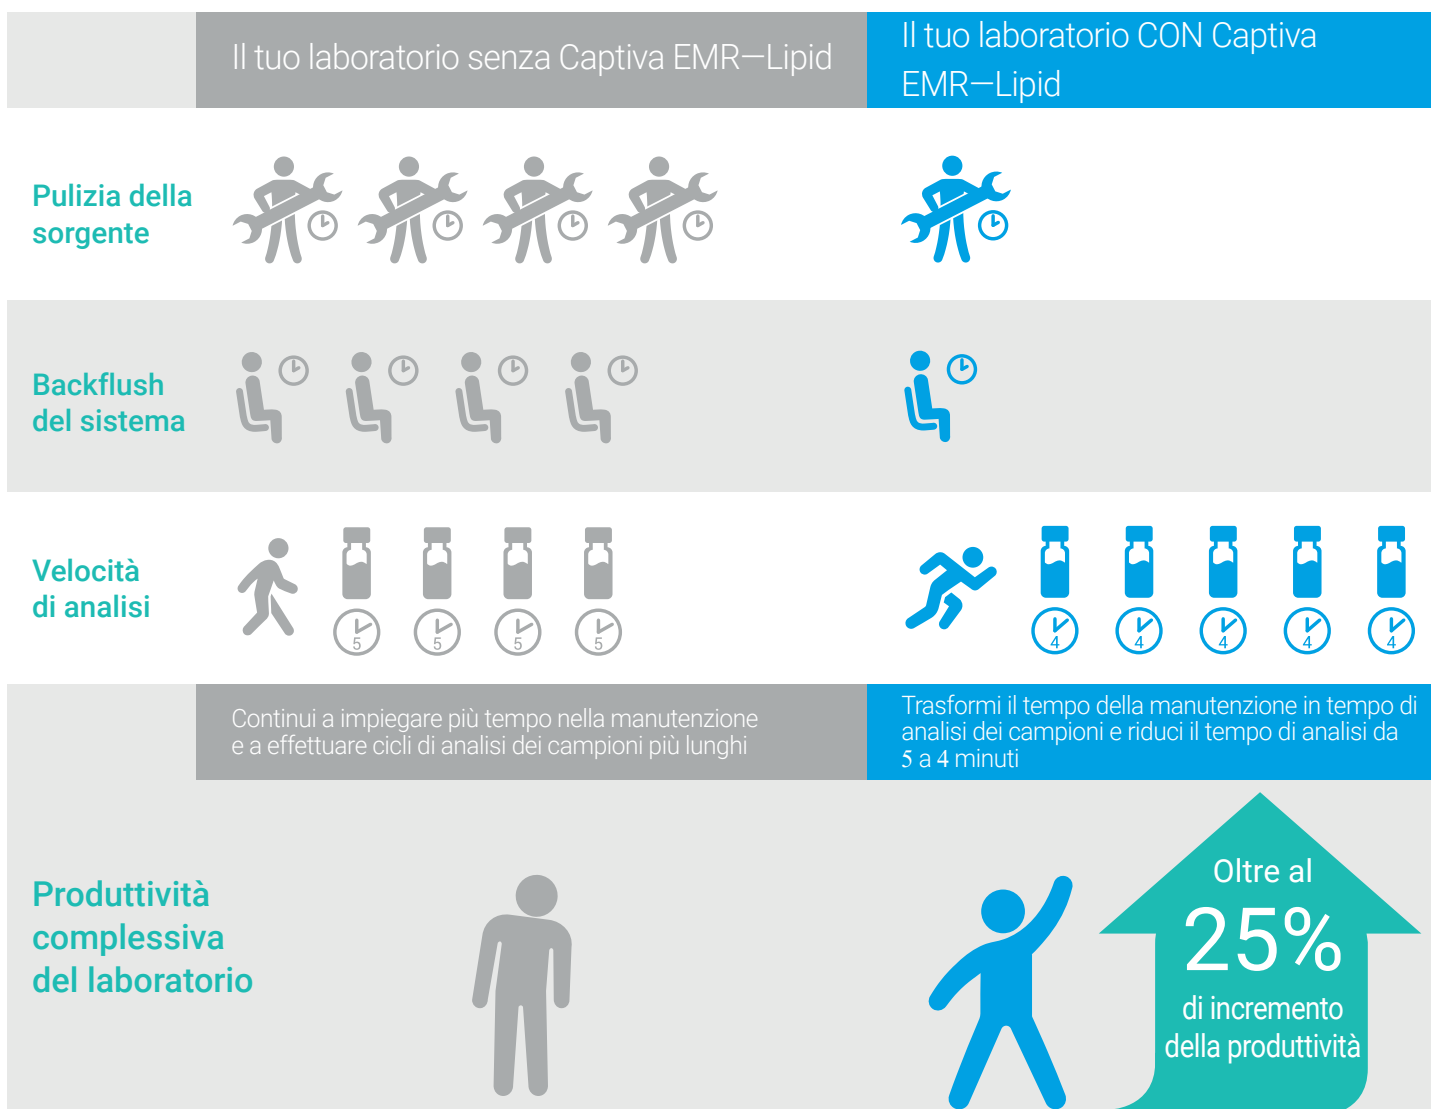

Questo scenario è basato su di un laboratorio a elevata produttività che analizza approssimativamente 6.500 campioni al mese con un unico strumento (LC/MS/MS). Questo laboratorio sta cercando di operare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con un tempo di analisi LC di 5 minuti. In questo laboratorio, allo stato attuale, i tecnici devono effettuare il lavaggio della colonna di routine e pulire la sorgente MS una volta al mese.

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

Ti interessa saperne di più su possibili miglioramenti della produttività? Comincia a esplorare:  
[www.agilent.com/chem/did-you-know](http://www.agilent.com/chem/did-you-know)